

Phonak Bolero B

(B90/B70/B50/B30)

Manual do usuário



Uma marca Sonova

PHONAK
life is on

Este manual do usuário é válido para:

Modelos wireless

Marca CE

Phonak Bolero B90-M	2016
Phonak Bolero B90-P	2016
Phonak Bolero B90-SP	2016
Phonak Bolero B70-M	2016
Phonak Bolero B70-P	2016
Phonak Bolero B70-SP	2016
Phonak Bolero B50-M	2016
Phonak Bolero B50-P	2016
Phonak Bolero B50-SP	2016
Phonak Bolero B30-M	2016
Phonak Bolero B30-P	2016
Phonak Bolero B30-SP	2016



Detalhes dos seus aparelhos auditivos

i Caso não tenha nenhuma informação assinalada abaixo e você desconheça o modelo do seu aparelho auditivo, pergunte ao seu profissional de saúde auditiva.

Modelo

Tamanho de bateria

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Bolero B-M | 312 |
| <input type="checkbox"/> Bolero B-P | 13 |
| <input type="checkbox"/> Bolero B-SP | 13 |

Peça

- Oliva ou microMolde
- Molde auricular

Profissional de saúde auditiva:

┌

└

┌

└

Seus aparelhos auditivos foram desenvolvidos pela Phonak – líder mundial em soluções auditivas com base em Zurique, Suíça.

Estes produtos de alta tecnologia são o resultado de décadas de pesquisas e experiência e foram desenvolvidos para mantê-lo conectado à beleza do som! Agradecemos por fazer uma ótima escolha e desejamos muitos anos de escuta prazerosa.

Leia o manual do usuário com atenção para se beneficiar de todos os recursos que o seu novo aparelho auditivo tem a oferecer. Para mais informações sobre características e benefícios, entre em contato com o seu profissional de saúde auditiva.


Phonak – life is on
www.phonak.com.br

Índice


O seu aparelho auditivo	
1. Guia rápido	6
2. Componentes do aparelho auditivo	8
Utilização do aparelho auditivo	
3. Identificação do aparelho auditivo (esquerdo e direito)	10
4. Ligar/Desligar	11
5. Bateria	12
6. Inserir o aparelho auditivo	14
7. Retirar o aparelho auditivo	16
8. Botão	18
9. Controle de volume	19
Mais informações	
10. Cuidados e manutenção	20
11. Acessórios sem fio	24
12. Assistência e garantia	27
13. Informações sobre conformidade	29
14. Informações e explicações sobre os símbolos	34
15. Resolução de problemas	38
16. Informações importantes sobre a segurança	40

1. Guia rápido

Identificação do aparelho auditivo (esquerdo e direito)



Bolero B-M




Bolero B-P, B-SP

Indicação azul para o **aparelho auditivo esquerdo**.


Indicação vermelha para o **aparelho auditivo direito**.

Substituir a bateria




1

Remova o selo protetor da bateria nova e aguarde dois minutos.



2


Abra o compartimento da bateria.




3

Insira a bateria com o símbolo "+" voltado para cima.

Ligar/Desligar




Ligar




Desligar

Botão



O botão existente no seu aparelho auditivo pode ter diferentes funções.

Controle de volume




Apenas para Bolero B-P e B-SP:
Para aumentar o volume, pressione o controle de volume para cima. Para diminuir o volume, pressione o controle de volume para baixo.

2. Componentes do aparelho auditivo


As imagens abaixo mostram os modelos descritos neste manual do usuário. A identificação do seu modelo pode ser feita da seguinte forma:

- Verifique "Detalhes dos seus aparelhos auditivos" na página 3
- Ou compare seu aparelho auditivo com os seguintes modelos mostrados. Fique atento quanto a forma do aparelho auditivo e se possui um controle de volume.


Possíveis peças para todos os modelos



Oliva




microMolde




Molde auricular

Bolero B-M

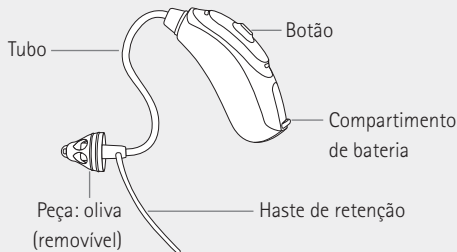


Bolero B-P e B-SP

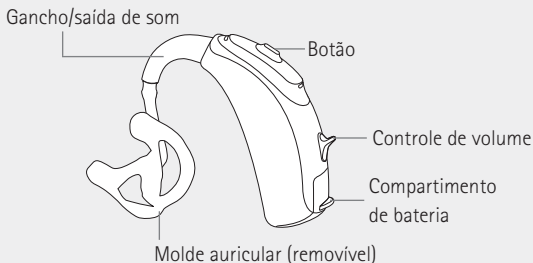


3. Identificação do aparelho auditivo (esquerdo e direito)

Existe uma indicação vermelha ou azul que irá lhe mostrar se o aparelho auditivo é da orelha esquerda ou direita.



Bolero B-M



Bolero B-P, B-SP

Indicação azul para o **aparelho auditivo esquerdo.**


Indicação vermelha para o **aparelho auditivo direito.**

4. Ligar/Desligar

O compartimento de bateria também possui a função liga/desliga.


1

Compartimento de bateria
fechado = aparelho auditivo
ligado




2

Compartimento de bateria
aberto = aparelho auditivo
desligado




i Ao ligar o aparelho auditivo você ouvirá uma melodia inicial.

5. Bateria




1

Remova o selo protetor da bateria nova e aguarde dois minutos.



2

Abra o compartimento da bateria.



3

Insira a bateria com o símbolo "+" voltado para cima.

- ⓘ Caso encontre dificuldade para fechar o compartimento da bateria: verifique se a bateria está inserida corretamente e se o símbolo "+" está voltado para cima. Se a bateria não estiver inserida corretamente, o aparelho auditivo não funcionará e o compartimento da bateria pode ser danificado.



Bateria fraca: você ouvirá dois bipes quando a bateria estiver fraca. Após este sinal, você tem cerca de 30 minutos para substituir a bateria (isso pode variar, dependendo das configurações do aparelho auditivo e da bateria). Recomendamos sempre ter uma bateria reserva disponível.

Substituir a bateria

Este aparelho auditivo utiliza bateria de zinco-ar. Identifique o tamanho correto da bateria (312 ou 13) da seguinte forma:

- Verifique "Detalhes dos seus aparelhos auditivos" na página 3.
- Verifique a indicação no interior do compartimento da bateria.
- Verifique a tabela a seguir.

Modelo	Tamanho da bateria de zinco-ar	Marca colorida na embalagem	Código IEC	Código ANSI
Phonak Bolero				
B-M	312	marrom	PR41	7002ZD
B-P, B-SP	13	laranja	PR48	7000ZD




Por favor, certifique-se em utilizar o modelo correto de bateria em seus aparelhos auditivos (zinco-ar). Leia também o capítulo 16.2 para mais informações sobre a segurança do produto.

6. Inserir o aparelho auditivo

6.1 Inserir o aparelho auditivo com molde auricular


1

Leve o molde a sua orelha e insira a ponta do molde em seu canal auditivo.




2

Coloque o aparelho auditivo atrás da orelha.



3


Insira a parte superior do molde na parte superior da concha da sua orelha.



6.2 Inserir o aparelho auditivo com oliva ou microMolde


1

Coloque o aparelho auditivo atrás da orelha.




2

Insira a peça no canal auditivo.



3

Se o seu aparelho auditivo possui uma haste de retenção, posicione-a dentro do pavilhão para fixar o seu aparelho auditivo.




7. Retirar o aparelho

7.1 Retirar o aparelho auditivo com molde auricular


1

Levante o aparelho auditivo acima da parte superior da sua orelha.



2

Segure o molde e remova-o delicadamente.




i Evite apertar o tubo ao retirar o aparelho auditivo.

7.2 Retirar o aparelho auditivo com oliva ou microMolde

1


Puxe pela curvatura do tubo e retire o aparelho auditivo de trás da orelha.



⚠ Em casos muito raros, a oliva pode permanecer em seu canal auditivo quando o aparelho for removido do ouvido. No caso, pouco provável, da oliva ficar presa no interior do canal auditivo, recomendamos que consulte um médico especialista para uma remoção segura.

8. Botão

O botão existente no seu aparelho auditivo pode ter diferentes funções ou estar desativado. Isto depende da programação do aparelho auditivo, que está indicada individualmente nas "Instruções do aparelho auditivo". Converse com seu profissional de saúde auditiva.

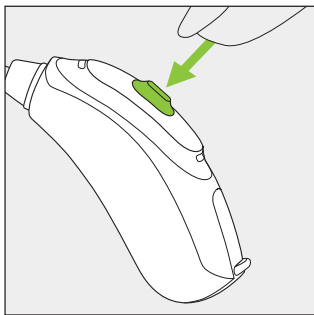


9. Controle de volume

Apenas para Bolero B-P e B-SP:

Para aumentar o volume, pressione o controle de volume para cima. Para diminuir o volume, pressione o controle de volume para baixo.

O controle de volume pode ser desativado pelo profissional de saúde auditiva.

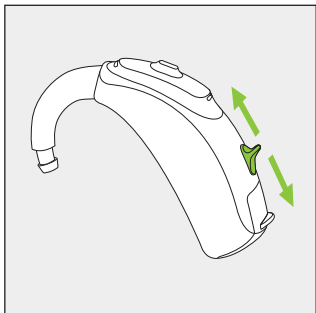

10. Cuidados e manutenção

O uso e cuidados adequados do seu aparelho auditivo contribuem para um excelente desempenho e um tempo de vida útil prolongado.

Utilize as seguintes especificações como diretrizes. Para mais informações sobre a segurança do produto, consulte o capítulo 16.2.

Informações gerais

Antes de usar spray de cabelo ou aplicar cosméticos, remova o aparelho auditivo do ouvido, pois esses produtos podem danificá-lo.

Quando você não estiver usando o seu aparelho auditivo, deixe o compartimento da bateria aberto para permitir a evaporação de qualquer umidade. Certifique-se de sempre secar completamente o aparelho auditivo após o uso. Armazene o aparelho em um local seguro, seco e limpo.

Seu aparelho auditivo é resistente à água, suor e poeira sob as seguintes condições:

- Que o compartimento da bateria esteja totalmente fechado. Assegure que nenhum objeto estranho, como cabelo, esteja preso no compartimento da bateria quando estiver fechado.
- Após a exposição à água, suor ou poeira, o aparelho auditivo deve ser limpo e seco.
- O aparelho auditivo é utilizado e mantido conforme descrito neste manual do usuário.

- ① Os aparelhos auditivos com o receptor específico Roger também são resistentes à água.
- ① Aparelhos auditivos com uma sapata de áudio e receptor Roger X não são resistentes à água.
- ① O uso do seu aparelho auditivo dentro da água pode restringir o fluxo de ar nas baterias, fazendo com que ele pare de funcionar. Se o seu aparelho auditivo parar de funcionar após entrar em contato com a água, consulte as etapas de solução de problemas no capítulo 15.

Diariamente

Inspeccione a peça (oliva, molde ou microMolde) e o tubo para verificar se há depósitos de cera e umidade. Limpe as superfícies com um pano que não solte fiapos ou use a escova pequena fornecida no estojo do aparelho auditivo. Nunca utilize produtos de limpeza domésticos (sabão em pó, sabonete, etc.) para limpar o aparelho auditivo. Não é recomendado enxaguar as peças, uma vez que a água pode se alojar no tubo. Se você precisar fazer uma limpeza profunda do aparelho auditivo, peça orientações e informações sobre filtros e cápsulas desumificadoras ao seu profissional de saúde auditiva.

Semanalmente

Limpe a peça com um pano úmido e macio ou um pano de limpeza especial para aparelhos auditivos. Para outras instruções de limpeza e manutenção, consulte seu profissional de saúde auditiva.


Mensalmente

Inspeccione o tubo para ver se há alterações na cor, endurecimento ou rachaduras. No caso dessas alterações, o tubo deve ser trocado. Consulte um profissional de saúde auditiva.

11. Acessórios sem fio

11.1 Conectando a fontes de áudio e controle remoto

Está disponível uma variedade de acessórios Phonak para a utilização com o seu aparelho auditivo.

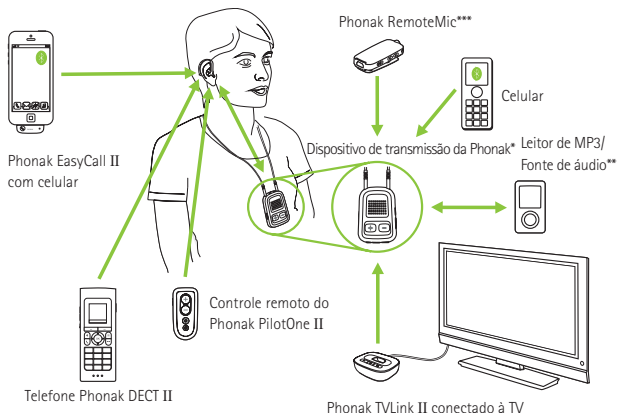

* O Phonak ComPilot II com colar ou ComPilot Air II com clip para prender à roupa. Também possuem as funcionalidades de controle remoto básicas. Para controle avançado, precisam ser usados com o Phonak RemoteControl App.

** Fontes de áudio (por exemplo, leitor de MP3, computador, laptop, tablet) podem ser conectadas ao dispositivo de transmissão via Bluetooth ou cabo de áudio.


*** Preso na roupa do interlocutor para um melhor entendimento de fala à distância.

A disponibilidade dos acessórios depende do país


11.1 Comunicação em ambientes ruidosos e à distância

O portfólio Roger fornece um desempenho do microfone extraordinário para ajudá-lo a compreender melhor em ambientes ruidosos e à distância. Com o Roger você pode se beneficiar:

- compreender cada palavra em situações ruidosas, por ex. restaurantes, áreas públicas e à distância.
- design discreto.
- transmissão da fala diretamente para os seus aparelhos auditivos com o receptor específico ou através de um receptor com colar.



Opção de receptor específico



Opção de receptor com colar



Microfone*

* Alguns microfones Roger também suportam entradas de fontes de áudio através do Bluetooth® ou cabo.

Bluetooth® é uma marca registrada de propriedade de Bluetooth SIG, Inc.

12. Assistência e garantia

Garantia local

Por favor, pergunte para o seu profissional de saúde auditiva, onde você adquiriu o seu aparelho auditivo, sobre os termos da garantia local.

Garantia internacional

A Sonova AG oferece um ano de garantia internacional, válida a partir da data de compra do aparelho. Essa garantia limitada cobre defeitos no material e de fabricação do aparelho auditivo propriamente dito, mas não cobre acessórios, tais como bateria, tubos, moldes e receptores externos. A garantia só é válida se o comprovante de compra for apresentado.

A garantia internacional não afeta quaisquer direitos legais que você possa ter sob legislação nacional aplicável que rege a venda de bens de consumo.

Limitações de garantia

A garantia não cobre danos por uso ou cuidados inadequados, exposição a produtos químicos ou tensão exagerada. Danos causados por terceiros ou centros de serviço não autorizados tornam a garantia nula e sem validade legal. Essa garantia não cobre qualquer serviço desempenhado por um profissional de saúde auditiva em seu consultório.

Número de série
(lado esquerdo):

Profissional de saúde auditiva
autorizado (carimbo/assinatura):

Número de série
(lado direito):

Data de aquisição:

13. Informações sobre conformidade

Europa:

Declaração de conformidade

Por meio deste documento, a Sonova AG declara que este produto atende aos requisitos da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC, assim como a Diretiva de Equipamentos de Terminal de Rádio e Telecomunicações 1999/5/EC. O texto completo da Declaração de Conformidade pode ser obtido por meio do fabricante ou com o representante local da Phonak, cujo endereço pode ser retirado da lista no site www.phonak.com (loais Phonak em todo o mundo).

Austrália/Nova Zelândia:



R-NZ

Indica a conformidade do dispositivo com as disposições regulamentares da RSM (Radio Spectrum Management) e da ACMA (Australian Communications and Media Authority) para a venda legal na Nova Zelândia e Austrália. O selo de conformidade R-NZ aplica-se a produtos de rádio fornecidos no mercado da Nova Zelândia sob o nível de conformidade A1.

Os modelos wireless descritos na página 2 estão certificados em:

Phonak Bolero B-M

EUA	FCC ID: KWC-WHSBTEM
Canadá	IC: 2262A-WHSBTEM

Phonak Bolero B-P

EUA	FCC ID: KWC-WHSBTEP
Canadá	IC: 2262A-WHSBTEP

Phonak Bolero B-SP

EUA	FCC ID: KWC-WHSBTESP
Canadá	IC: 2262A-WHSBTESP

Aviso 1:

Este aparelho está em conformidade com a seção 15 das regras da FCC e com a RSS-210 da Industry Canada.

O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir:

- 1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e
- 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar funcionamento indesejado.

Aviso 2:

Alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Sonova AG podem anular a autorização da FCC para a operação deste dispositivo.

Aviso 3:

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Seção 15 das regras da FCC e ICES-003 da Industry Canada. Esses limites foram desenvolvidos para fornecer proteção razoável contra interferência danosa em uma instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de

acordo com as instruções, pode causar interferência danosa às comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este dispositivo não causar interferência danosa à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter auxílio.

Informações de rádio do seu aparelho auditivo sem fio

Tipo de antena	Antena de bobina de ferrite integrada (indutiva)
Frequência de operação	10,6 MHz
Largura de banda ocupada (99% BW)	Aprox. 500 kHz
Modulação	DQPSK
Canal	Rádio de canal único
Alcance operacional	18 cm
Caso de utilização	Transmissão de áudio ou sinal de comando para aparelho auditivo receptor no outro ouvido
Intensidade do campo magnético @ 3 m	-20.5 dB μ A/m

14. Informações e explicações sobre os símbolos



Com o símbolo da CE, a Sonova AG confirma que este produto – incluindo os acessórios – cumpre as exigências da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/ EEC e da Diretiva R&TTE 1999/5/EC sobre transmissores de rádio e telecomunicações. Os números após o símbolo da CE correspondem ao código das instituições certificadas que foram consultadas sob as diretivas mencionadas acima.



Este símbolo indica que os produtos descritos neste manual do usuário cumprem as exigências de peça aplicada do tipo B segundo a norma EN 60601-1. A superfície do aparelho auditivo é especificada como peça aplicada do tipo B.



Este símbolo indica que o fabricante do dispositivo médico cumpre as exigências da Diretiva Europeia 93/42/CEE.



Manter seco durante o transporte.



Este símbolo indica que é importante que o usuário leia e leve em consideração as informações relevantes deste manual do usuário.



Este símbolo indica que é importante que o usuário preste atenção às advertências relevantes deste manual do usuário.



Informações importantes para a segurança do produto e manuseio.

**Condições
de funciona-
mento**

O produto foi desenvolvido para funcionar sem problemas ou restrições se utilizado para o efeito a que se destina, salvo indicação em contrário neste manual do usuário. Os aparelhos auditivos têm a classificação IP68 (profundidade de 1 metro durante 60 minutos) e foram projetados para serem usados em qualquer situação do cotidiano. Por isso, você não tem de se preocupar com o aparelho auditivo ao tomar banho ou quando transpira. Porém, o aparelho auditivo não se destina a atividades aquáticas que envolvam água clorada, sabão, água salgada ou outros líquidos com conteúdo químico.

SN

Indica o número de série do fabricante para que um dispositivo médico específico possa ser identificado.

REF

Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.



Temperatura durante o transporte e armazenamento: -20° à $+60^{\circ}$ Celsius



Umidade durante o transporte: até 90% (sem condensação).

Umidade durante o armazenamento: 0% à 70%, se não em uso. Veja as instruções no capítulo 16.2 sobre a secagem dos aparelhos auditivos após o uso.



Pressão atmosférica: 200 hPA à 1500 hPa



O símbolo com a lixeira riscada com um X destina-se a conscientizá-lo de que este aparelho auditivo não pode ser jogado fora como o lixo doméstico comum. Descarte aparelhos auditivos velhos ou sem uso em locais específicos para esse tipo de descarte, ou entregue o aparelho auditivo para um profissional de saúde auditiva para que ele os descarte. O descarte adequado protege a saúde e o meio ambiente.

15. Resolução de problemas

Problema

Aparelho auditivo não funciona

Aparelho auditivo com microfonia (apito)

Volume do aparelho auditivo está abaixo do comum ou o som está distorcido

Aparelho auditivo emite dois bipes

Aparelho auditivo liga e desliga (intermitente)

Causas

Bateria descarregada

Receptor/oliva obstruídos

Bateria não inserida corretamente

Aparelho auditivo desligado

Aparelho auditivo não inserido corretamente

Cera no canal auditivo

Volume muito alto

Bateria fraca

Receptor/oliva obstruídos

Volume muito baixo

Condição física auditiva alterou

Indicação de bateria fraca

Umidade na bateria ou no aparelho auditivo

i Se o problema persistir, contate o seu profissional de saúde auditiva para obter assistência.

O que fazer

Substituir a bateria (capítulo 1 + 5)

Limpar abertura do receptor/oliva

Inserir corretamente a bateria (capítulo 1 + 5)

Ligar o aparelho auditivo ao fechar completamente o compartimento da bateria (capítulo 4)

Inserir o aparelho auditivo corretamente (capítulo 6)

Contate o seu médico otorrinolaringologista ou profissional de saúde auditiva

Diminuir volume (capítulo 8 + 9)

Substituir a bateria (capítulo 1 + 5)

Limpar abertura do receptor/oliva

Aumentar o volume, se disponível (capítulo 8 + 9)

Entre em contato com o seu profissional de saúde auditiva

Substitua a bateria nos próximos 30 minutos (capítulo 1 + 5)


Limpe a bateria e o aparelho auditivo com um pano seco


16. Informações importantes sobre a segurança

Leia cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho auditivo pela primeira vez.


Um aparelho auditivo não vai restaurar a audição normal, prevenir ou melhorar uma perda auditiva resultante de condições orgânicas. O uso pouco frequente de um aparelho auditivo impede que o usuário obtenha o benefício total oferecido. O uso do aparelho auditivo é apenas uma parte da reabilitação auditiva que poderá ser complementada por treinamento auditivo e orientação em leitura labial.


16.1 Avisos de perigo

 Os aparelhos auditivos são destinados a amplificar e transmitir som aos ouvidos e compensar a deficiência auditiva. Os aparelhos auditivos (especialmente programados para cada tipo de perda auditiva) devem ser usados apenas pela pessoa pretendida. Eles não devem ser utilizados por qualquer outra pessoa, pois podem prejudicar a audição.


 Não são permitidas alterações ou modificações no aparelho auditivo que não tenham sido explicitamente aprovadas pela Sonova AG. Essas


alterações podem danificar o seu ouvido ou o aparelho auditivo.


 Não use aparelhos auditivos em áreas explosivas minas ou áreas industriais com perigo de explosão, ambientes ricos em oxigênio ou áreas de manuseio de anestésicos inflamáveis.


 As baterias do aparelho auditivo causam intoxicação se ingeridas! Mantenha-as fora do alcance de crianças, pessoas com déficit cognitivo ou animais. Se as baterias forem ingeridas,


consulte seu médico imediatamente!


 Se você sentir dor dentro ou atrás da orelha, se elas inflamarem, se a pele ficar irritada ou ocorrer acúmulo de cera na orelha, consulte um médico ou um profissional de saúde auditiva.

 Em casos muito raros, a oliva pode permanecer em seu canal auditivo ao remover o aparelho auditivo do ouvido. No caso improvável da peça (oliva, molde ou microMolde) ficar presa no seu canal auditivo, é altamente recomendado procurar um médico para removê-la com segurança.

 Os programas auditivos no modo de microfone direcional reduzem os ruídos de fundo. Fique atento, pois os sinais de alerta ou ruídos que vêm de trás, por exemplo de um carro, são parcial ou totalmente suprimidos.

 Este aparelho auditivo não é recomendado para crianças com menos de 36 meses. O aparelho auditivo contém peças pequenas que podem causar asfixia, se ingeridas. Mantenha fora do alcance de crianças, pessoas com déficit cognitivo ou animais. Se ingeridas, consulte um médico ou vá para um hospital imediatamente.


 Não faça conexões com fio entre o aparelho auditivo e qualquer fonte de áudio externa, como um rádio. Pois você poderá causar lesões no corpo (risco de choque elétrico).

 As informações a seguir devem ser seguidas por pessoas com dispositivos médicos implantáveis ativados (ex.: marcapassos, desfibriladores, etc.):

- Mantenha os aparelhos auditivos wireless a pelo menos 15cm de distância do dispositivo implantado. Caso perceba alguma interferência, não utilize os aparelhos auditivos wireless e entre em contato com o fabricante do

implante ativo. Por favor, observe que a interferência também pode ser causada por linhas de energia, descarga eletroestática, detectores de metais de aeroportos, etc.

- Mantenha ímãs (ex.: ferramenta de manipulação de bateria, ímã do EasyPhone, etc.), a pelo menos 15cm de distância do implante ativo.
- Se você usar um acessório sem fio para Phonak, consulte a seção "Informações importantes sobre a segurança" do manual do usuário do acessório sem fio.

 Os aparelhos auditivos não devem ser adaptados com olivas fechadas/sistemas de proteção de cera usados por pacientes com tímpanos perfurados, condutos do ouvido inflamados ou quaisquer outras cavidades da orelha média expostas. Nestes casos, recomendamos o uso de um molde ou microMolde personalizado. No caso improvável de o molde ou microMolde ficar preso no conduto auditivo, é altamente recomendável consultar um médico especialista para a remoção segura.

16.2 Notas de segurança

- ① Os aparelhos auditivos Phonak são resistentes à água e não à prova d'água. Eles são projetados para suportar as atividades normais e ocasionalmente à exposição acidental em condições extremas. Nunca mergulhe o seu aparelho auditivo na água! Os aparelhos auditivos Phonak não foram especificamente projetados para submersão em água durante um longo período, como por exemplo, natação ou tomar banho. Sempre retire seu aparelho auditivo antes destas atividades, pois os aparelhos auditivos contém partes eletrônicas sensíveis.
- ① Nunca lave as entradas dos microfones. Isso pode fazer com que percam as suas características acústicas especiais.
- ① Proteja o seu aparelho auditivo do calor (nunca o deixe perto de uma janela ou dentro do carro). Nunca utilize um micro-ondas ou outros dispositivos de aquecimento para secar o aparelho auditivo. Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva quais são os métodos adequados de secagem.
- ① A oliva fechada deve ser trocada a cada três meses ou quando ela se tornar

rígida ou frágil. Este procedimento serve para evitar que a oliva fechada se solte da ponta do tubo durante a inserção na orelha ou remoção dela.

- ① Quando você não estiver usando o seu aparelho auditivo, deixe o compartimento da bateria aberto para permitir a evaporação de qualquer umidade. Certifique-se de sempre secar completamente o aparelho auditivo após o uso. Armazene o aparelho em um local seguro, seco e limpo.
- ① Não derrube o aparelho auditivo! Uma queda sobre

uma superfície rígida pode danificá-lo.

- ① Utilize sempre baterias novas no seu aparelho auditivo. No caso de vazamento da bateria, substitua-a imediatamente para evitar irritação da pele. Você pode devolver as baterias usadas ao seu profissional de saúde auditiva.
- ① As baterias usadas nos aparelhos auditivos não excedem 1.5 Volts. Por favor, não utilize baterias recarregáveis de prata-zinco ou Íons de Lítio (lithium-ion), pois podem causar sérios danos em seus aparelhos auditivos.

A tabela no capítulo 5 mostra exatamente qual o tipo de bateria indicada para os seus aparelhos auditivos.

- ① Remova a bateria se não for usar o aparelho auditivo durante um período prolongado.
- ① Exames médicos ou odontológicos, incluindo a radiação, descritos abaixo, podem afetar desfavoravelmente o funcionamento correto dos seus aparelhos auditivos. Recomendamos removê-los antes dos procedimentos e mantê-los fora da sala/área:

- Exames médicos ou odontológicos com raio-X (incluindo Tomografia Computadorizada)
- Exames médicos como Ressonância Magnética (MRI) e Ressonância Magnética Nuclear (NMRI), geram campos magnéticos. Os aparelhos auditivos não precisam ser retirados ao passar em portões de segurança (ex.: aeroportos, etc.). Caso o raio-X seja utilizado, será em doses muito baixas e não afetará os aparelhos auditivos.
- ① Não utilize o aparelho auditivo em áreas onde equipamentos eletrônicos não são permitidos.

**Fabricante:**

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suiça

Importado e distribuído por:

Sonova do Brasil Produtos Audiológicos Ltda.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco A, 4º andar, conj. 02 e 03
Cep: 05804-900 - São Paulo/SP
Tel (11) 3747-7222 - Fax (11) 3747-7016
e-mail: sac.brasil@phonak.com.br
SAC: 0800 701 8105
CNPJ: 92.792.530/0001-38
Registro ANVISA nº: 10283310173
Resp. téc: Michelle Queiroz Zattoni - CRFa/SP: 10.327
www.phonak.br

sonova
HEAR THE WORLD

