Phonak Sky B-RIC (B90/B70/B50/B30) (xS)

Wasserresistentes Ex-Hörer (RIC) Gerät, mit 13er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie die Produktinformation oder besuchen Sie www.phonakpro.com.

Phonak Sky B-RIC Geräte können sowohl mit einem Standard (xS), Power (xP) oder UltraPower (xUP) Ex-Hörer angepasst werden.

Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

Ausgangsschalldruck

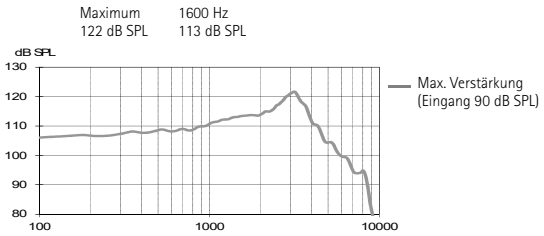

Akustische Verstärkung

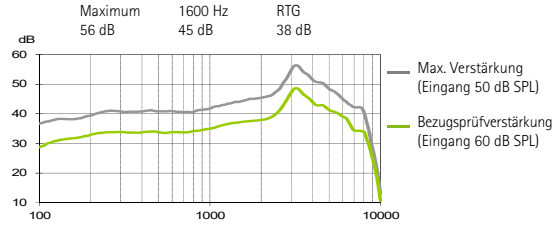

Frequenzbereich	<100 Hz - 9200 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1.5%	2%	2.5%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	1.3 mA	1.4 mA	
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

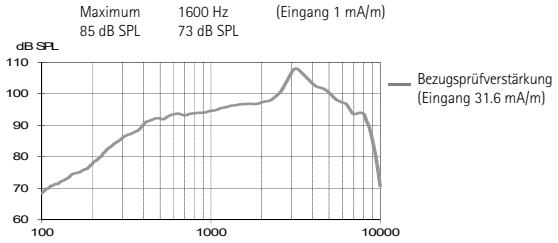

Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

2cm^3 Kuppler-Daten

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0: 2015

Ausgangsschalldruck

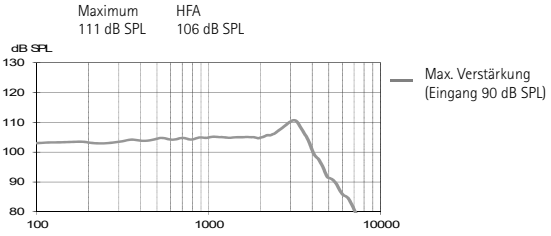

Akustische Verstärkung

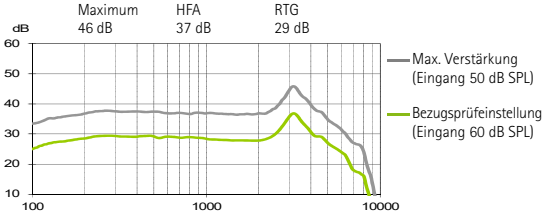

Frequenzbereich	<100 Hz - 8800 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1.5%	2%	2%
Batteriestrom	1.4 mA		
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

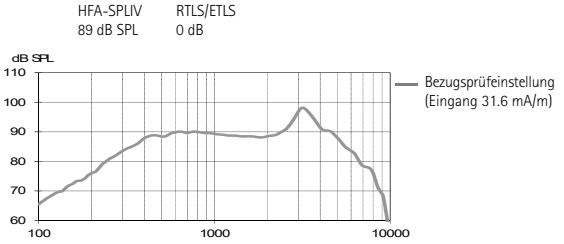

CE 0459

PHONAK

A Sonova brand

V1.00/2017-/MC © 2017 Sonova AG All rights reserved/page 1/3

Phonak Sky B-RIC (B90/B70/B50/B30) (xP)

Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

Ausgangsschalldruck

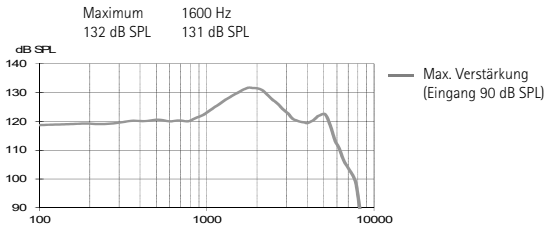

Akustische Verstärkung

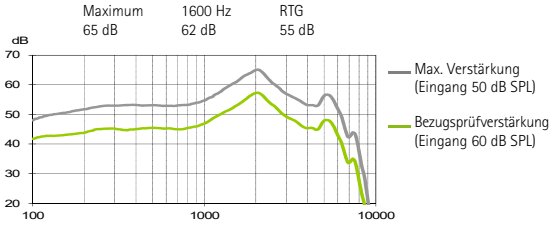

Frequenzbereich	<100 Hz - 6400 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1.5%	1.5%	1.5%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	1.3 mA	1.4 mA	
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

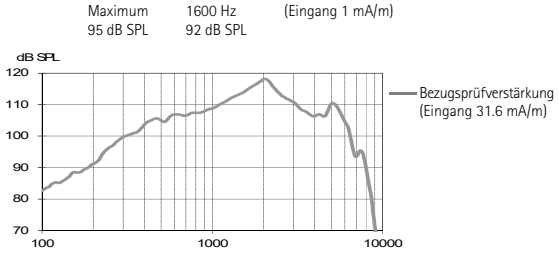

2cm^3 Kuppler-Daten

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0: 2015

Ausgangsschalldruck

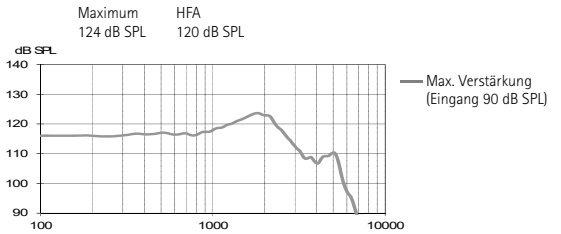

Akustische Verstärkung

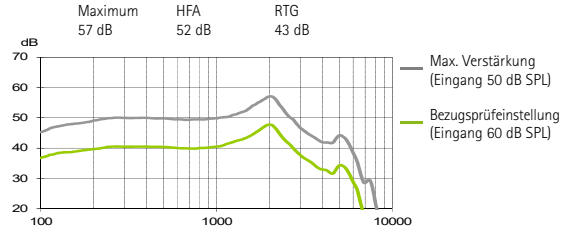

Frequenzbereich	<100 Hz - 6600 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Batteriestrom	1.4 mA		
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

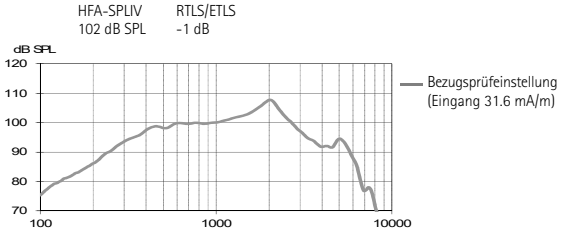

CE 0459

PHONAK

A Sonova brand

V1.00/2017-10/MC © 2017 Sonova AG All rights reserved/page 2/3

Phonak Sky B-RIC (B90/B70/B50/B30) (xUP)

Warnung an die Hörgeräte-Akustiker:
Dieses Hörsystem hat einen Ausgangsschalldruck, der 132 dB SPL übersteigen kann. Lassen Sie beim Anpassen dieses Gerätes besondere Vorsicht walten, da das Risiko einer Verletzung der Resthörigkeit des Benutzers besteht.

Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

Ausgangsschalldruck

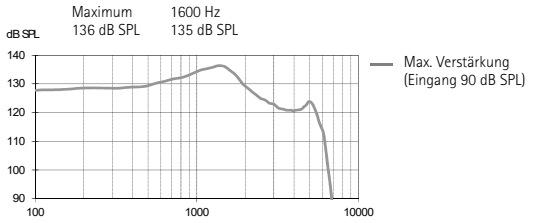

Akustische Verstärkung

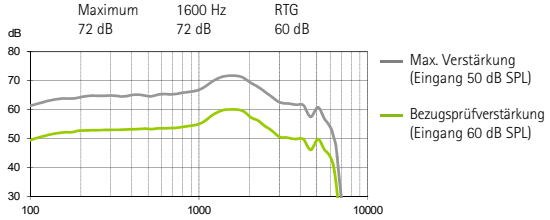

Frequenzbereich	<100 Hz - 5800 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	2%	1.5%	1%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	1.3 mA	1.5 mA	
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

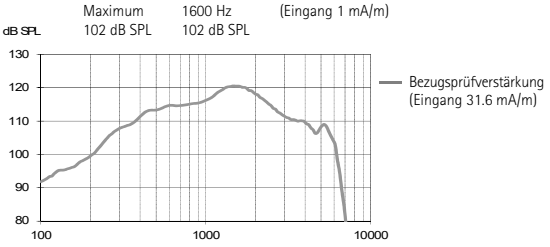

2cm^3 Kuppler-Daten

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0: 2015

Ausgangsschalldruck

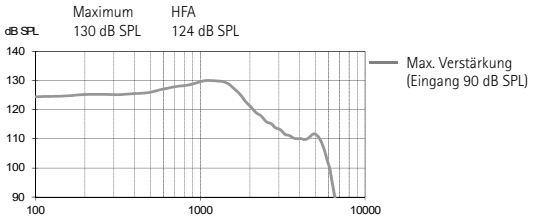

Akustische Verstärkung

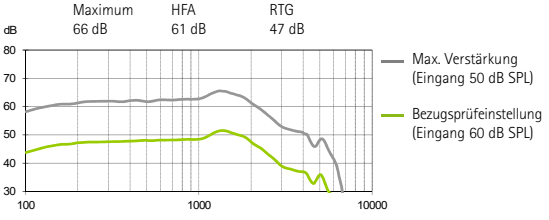

Frequenzbereich	<100 Hz - 6000 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1.5%	1.5%	1%
Batteriestrom	1.5 mA		
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

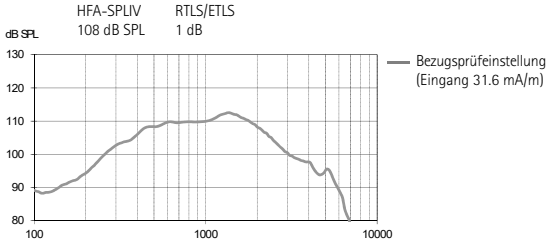

CE 0459

PHONAK

A Sonova brand

V1.00/2017-10/MC © 2017 Sonova AG All rights reserved/page 3/3