


Phonak Target™ 1.0

Anpassanleitung

Vorbereitung der Hörgeräte für die Anpassung

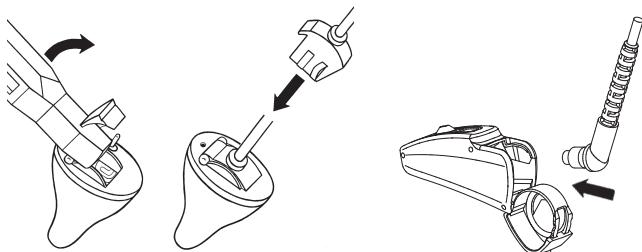


iCube

Setzen Sie die Batterie ein. Das Hörgerät wird durch das Schließen des Batteriefaches eingeschaltet.


NOAHlink oder HI-PRO

Verbinden Sie die Hörgeräte und die Programmierschnittstelle mit den Programmierkabeln.

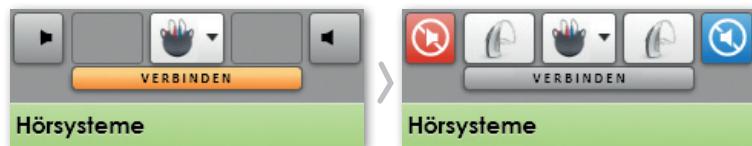

1.


Wählen Sie iCube, NOAHlink oder HI-PRO aus dem Menü aus. Klicken Sie [**VERBINDEN**], um mit der Anpassung zu beginnen. Die verbundenen Hörgeräte werden angezeigt.

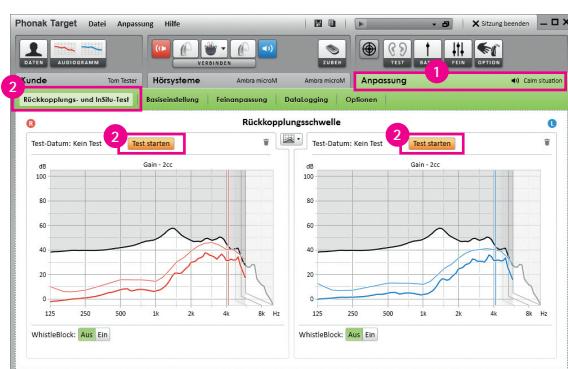

2.

1. Klicken Sie auf den Reiter [**Anpassung**].

2. Im Bildschirm [**Rückkopplungs- und InSitu-Test**] klicken Sie [**Test starten**], um den Test durchzuführen. Wählen Sie [**Geschätzte RECD und Bohrung benutzen**], um die Testergebnisse für die Berechnung der akustischen Parameter zu nutzen.

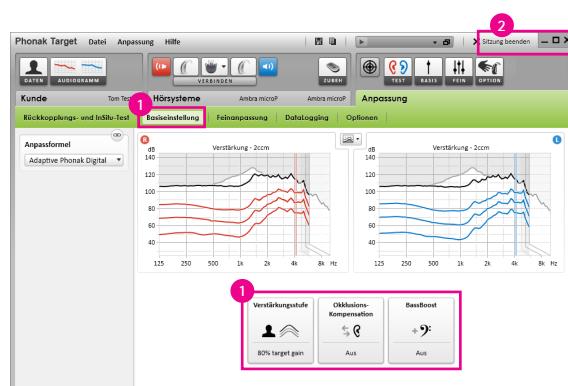

3.

1. Gehen Sie in die [**Basiseinstellung**], um die [**Verstärkungsstufe**], die [**Okkulations-Kompensation**] und den [**BassBoost**] anzupassen.

2. Klicken Sie [**Sitzung beenden**], um die Einstellungen in die Hörgeräte und in die Datenbank zu speichern.

PHONAK

life is on

Phonak Target™ 1.0

Tipps und Tricks

Zubehör anpassen



Phonak Target™ erkennt verbundenes Zubehör automatisch, wenn es während der Anpassung angeschlossen wird. Das erkannte Zubehör wird neben den verbundenen Hörgeräten angezeigt.

Zubehör kann im Reiter [Hörsysteme] > [Zubehör] auch manuell ausgewählt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Zubehör mit einem USB-Kabel an Ihrem Anpass-Computer angeschlossen ist.

Während des Abspeicherns wird das Zubehör im Informationsdialog angezeigt.

Anzeigen des Sprachspektrums für die Beratung



Klicken Sie auf den Reiter [Kunde] > [Audiogramm].

Wählen Sie im Bereich Audiogramm [Sprachspektrum anzeigen], um die Hörminderung im Sprachspektrum darzustellen.