



## Données

# Phonak Virto B

## Phonak Virto B-312 NW O (B90/B70/B50/B30) (M)

Intra-auriculaire compact, pile type 312. Pour la gamme d'appareillage, les détails sur les produits et les options disponibles, veuillez consulter la fiche Information Produit ou visiter le site [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).

Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.

Sans autre spécification, toutes les données ont été mesurées avec un tube de 5 mm et dans les réglages de mesure de Phonak Target.

### Données sur simulateur d'oreille


IEC 60118-0: 1994

### Données sur coupleur de 2cm<sup>3</sup>


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015


#### Niveau acoustique de sortie




#### Niveau acoustique de sortie



#### Gain acoustique




#### Gain acoustique




Bande passante	<100 Hz - 8000 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	2%	2,5%	2%
Consommation	Repos Fonctionnement		
	0.85 mA 0.95 mA		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	150 (130) h		

Bande passante	<100 Hz - 7000 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1,5%	1%
Consommation	Fonctionnement		
	1.2 mA		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	150 (130) h		

#### Sensibilité du capteur téléphonique



#### Sensibilité du capteur téléphonique



**PHONAK**

A Sonova brand



## Données

# Phonak Virto B

## Phonak Virto B-312 NW O

## (B90/B70/B50/B30) (P)

Intra-auriculaire compact, pile type 312. Pour la gamme d'appareillage, les détails sur les produits et les options disponibles, veuillez consulter la fiche Information Produit ou visiter le site [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).

Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.

Sans autre spécification, toutes les données ont été mesurées avec un tube de 5 mm et dans les réglages de mesure de Phonak Target.

### Données sur simulateur d'oreille


IEC 60118-0: 1994

### Données sur coupleur de 2cm<sup>3</sup>


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015


#### Niveau acoustique de sortie




#### Niveau acoustique de sortie



#### Gain acoustique




#### Gain acoustique

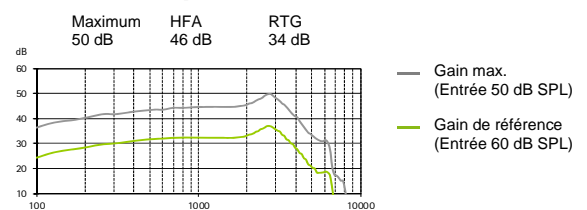


Bande passante	<100 Hz - 6800 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	2%	1%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	0.85 mA	0.95 mA	
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	164 (142) h		

Bande passante	<100 Hz - 6700 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Consommation	Fonctionnement		
	1.0 mA		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	150 (130) h		

#### Sensibilité du capteur téléphonique



#### Sensibilité du capteur téléphonique



PHONAK



## Données

# Phonak Virto B

## Phonak Virto B-312 NW O (B90/B70/B50/B30) (SP)

Intra-auriculaire compact, pile type 312. Pour la gamme d'appareillage, les détails sur les produits et les options disponibles, veuillez consulter la fiche Information Produit ou visiter le site [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com).

Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.

Sans autre spécification, toutes les données ont été mesurées avec un tube de 5 mm et dans les réglages de mesure de Phonak Target.

### Données sur simulateur d'oreille


IEC 60118-0: 1994

### Données sur coupleur de 2cm<sup>3</sup>


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015


#### Niveau acoustique de sortie




#### Niveau acoustique de sortie



#### Gain acoustique




#### Gain acoustique




Bande passante	<100 Hz - 7700 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1,5%	1%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	0.85 mA	0.95 mA	
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	150 (130) h		

Bande passante	<100 Hz - 7000 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Consommation	Fonctionnement		
	0.95 mA		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		
Durée de vie*	150 (130) h		

#### Sensibilité du capteur téléphonique



#### Sensibilité du capteur téléphonique



**PHONAK**

\* La durée de vie réelle de la pile dépend de sa qualité, du mode d'utilisation de l'appareil, des fonctionnalités actives, de l'utilisation d'accessoires de communication sans fil, de la perte auditive et de l'environnement sonore. (Type 312 ZN-Air, 180 mAh)