

Steg 1 – Generell information

Audionom: _____

Beställarid.: _____

Klinik: _____

Kontaktadress: _____



Patientnamn: _____

Kön/ålder: ☐ Man ☐ Kvinna Ålder: _____

Erfarenhet: ☐ Förstagångsanv. ☐ Erfaren

Leveransadress: _____

Audiogram:

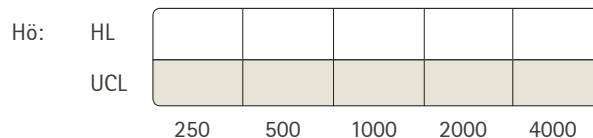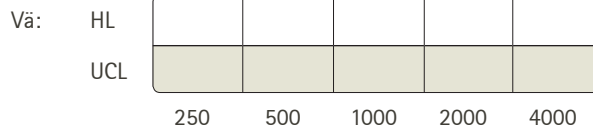

HL = hearing level UCL = uncomfortable level

Steg 2 – Produkt



Virto M-Titanium

☐ V ☐ H



Virto M-10 NW O

☐ V ☐ H



Virto M-312 NW O

☐ V ☐ H



Virto M-312

☐ V ☐ H

Steg 3 – Funktionsnivå

Virto M-Titanium

☐ M90 ☐ M70

Virto M-10 NW O/M-312 NW O/M-312

☐ M90 ☐ M70 ☐ M50

Steg 4 – Styrkeklass

Vä: ☐ M ☐ P ☐ SP ☐ UP*

Hö: ☐ M ☐ P ☐ SP ☐ UP*

Steg 5 – Färger

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Skal | Frontplatta |
| ☐ 06 Black* | ☐ 06 Black*** |
| ☐ 19 White | ☐ 22 Cocoa |
| ☐ 21 Transparent | ☐ 26 Pink |
| ☐ 22 Cocoa | ☐ 28 Brown |
| ☐ 26 Pink | |
| ☐ 28 Brown | |
| ☐ R/B Red/Blue | |
| ☐ UO Titanium gray** | |

*Bara till Virto M-312 riktlinj

**Bara till Virto M-Titanium

***Inte till Virto M-312 NW O

Steg 6 – Alternativ

Förklaring

☐ / ☐ (S) = Standard ☐ = Tillval

För tillval och deras koder, se matrisen på baksidan

Skalstorlek	Minsta möjliga	☐ (S)
	Eget val:	Modell:
Vent.storlek	AOV	☐ (S)
	AOV-O (Virto M-Titanium)	☐
	Eget val:	Vä: mm Hö: mm
Vaxsystem	Cerustop (CS)	☐ (S)
	Eget val:	Typ:
Kontroller	Standardkontroller	☐ (S)
	EasyPhone & tryckknapp	☐
	EasyPhone utan tryckknapp	☐
	MiniControl utan tryckknapp	☐
	Volymkontroll (VC)	☐
	Telespole	☐
Utdragstråd (RF)	Transparent (21)*	☐ (S)
	Utökad tråd +5 mm (RFE)	☐
Titaniumyta	Extra retention (ERS)	☐
	TV Connector	☐
Tillbehör (Virto M-312)	Phonak Partner Mic™	☐
	Phonak RemoteControl	☐

*Standard till IIC & CIC

Special-
instruktioner

Virto M

Beställning i-örat apparater

Kombinationsmatris

		Virto M-Titanium 	Virto M-10 NW O 	Virto M-312 NW O 	Virto M-312 
Skalstorlek		IIC, CIC	IIC, CIC, MC, C, HS, FS	MC, C, HS, FS	HS, FS
Tryckknapp	Standard	Ingen tryckknapp (PX)	Tryckknapp (PM1)	Ingen tryckknapp (PX)	Tryckknapp (PM1)
	Tillval	Tryckknapp (PM1)	Ingen tryckknapp (PX)	Tryckknapp (PM1)	-
Volymkontroll	Standard	-	Ingen VC (VCX)	Ingen VC (VCX)	Ingen VC (VCX)
	Tillval	-	Digital VC (VC3)	Digital VC (VC3)	Digital VC (VC3)
Telespole	Standard	Ingen telespole (TX)	Ingen telespole (TX)	Ingen telespole(TX)	-
	Tillval	Telespole passiv (TP)	Telespole passiv (TP) (inte möjligt tillsammans med VC)	Telespole passiv (TP) inte möjligt tillsammans med VC)	-
Magnetisk omkopplarfunktion	Standard	MiniControl (DT5)	EasyPhone (DT4)	EasyPhone (DT4)	-
	Tillval	EasyPhone (DT6)	MiniControl (DT3) Ingen magnetomkoppl.(RX)	Ingen magnetomkopplare (RX)	-
Vaxsystem	Standard	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)
	Tillval	-	HF3 (H3) HF4 (H4) Förlängd ht-slang (ER) Inget vaxsystem (X)	HF3 (H3) HF4 (H4) Förlängd ht-slang (ER) Inget vaxsystem(X)	HF3 (H3) HF4 (H4) Förlängd ht-slang (ER) Inget vaxsystem (X)
Utdragstråd	Standard	Transparent utdragstråd (RF)*	Transparent utdragstråd (RF)*	-	-
	Tillval	-	Transparent utdragstråd (RF)	Transparent utdragstråd (RF)	Transparent utdragstråd (RF)

*IIC & CIC kommer som standard med utdragstråd

Information

Ventilationsalternativ

AOV = Akustiskt Optimerad Vent. Phonak bestämmer vent-diameter och typ i relation till audiogram/örats anatomi/återkopplingshantering och behov av lågfrekvensförstärkning. Detta är den rekommenderade venttypen.

AOV-O = Akustiskt Optimerad Vent-Open. Denna vent är mer öppen och rekommenderas för förstagångsanvändare och de som är känsliga för ocklusion.

Avtryck

Rekommendation för djupa avtryck:

- Använd EasyView Otoblock
- Använd Dreve Otoform A softX 25 shore A (#29 56) eller liknande
- Fyll alltid hela conchan med massa
- Antitragus måste vara synlig